HOVERTECH International

Q2ROLLER®

Lateral Turning Device

Manual del usuario

Visite www.HoverMatt.com para ver el manual en otros idiomas

TABLA DE CONTENIDO

Uso previsto y precauciones 2
Identificación de piezas: Q2Roller 2
Identificación de piezas: Bomba insufladora de aire..... 2
Funciones del teclado de la Bomba insufladora de aire... 3
Instrucciones de uso 3
Especificaciones del producto y accesorios necesarios ... 3
Limpieza y mantenimiento..... 4
Devoluciones y reparaciones 4

Uso previsto y precauciones

INDICACIONES DE USO
Pacientes que no pueden girar o colocarse lateralmente por sí mismos

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con fracturas torácicas, cervicales o lumbares que se consideran inestables

ENTORNOS DE CUIDADO PREVISTOS
Hospitales o centros de atención a largo plazo o atención extendida

PRECAUCIONES
- Asegúrese de que el dispositivo Q2Roller cumpla con las necesidades del paciente antes de usarlo.
- Siempre debe participar un mínimo de dos cuidadores cuando se opere el dispositivo Q2Roller.
- Asegúrese de que las válvulas no estén en contacto con el paciente mientras este se encuentre sobre el dispositivo Q2Roller.
- El dispositivo solo debe ser usado por personal capacitado.
- Solo debe usar los accesorios autorizados por HoverTech International.
- Use el dispositivo Q2Roller según las instrucciones.
- Solo debe usarse con la función AJUSTABLE del dispositivo HT-Air.
- Asegúrese de que el paciente esté centrado en el dispositivo Q2Roller antes de inflarlo. Guíese con el indicador de línea central del dispositivo Q2Roller.
- Los cuidadores deben asegurarse de que el paciente esté estabilizado durante el inflado y el desinflado del dispositivo Q2Roller y cuando el dispositivo se infle a un ángulo mayor de 30 grados.
- No lavar.
- Consulte los manuales de usuario específicos del producto para ver instrucciones de operación adicionales.

PRECAUCIONES: HOVERTECH INTERNATIONAL BOMBA INSUFLADORA DE AIRE
- Coloque el cable de alimentación de forma que garantice que no haya peligros.
- Evite bloquear las entradas de aire de la Bomba insufladora de aire.
- Solo debe usar el producto para su uso previsto, como se describe en este manual.
- PRECAUCIÓN: Evite los choques eléctricos. No abra el suministro de aire.

Identificación de piezas: Q2Roller

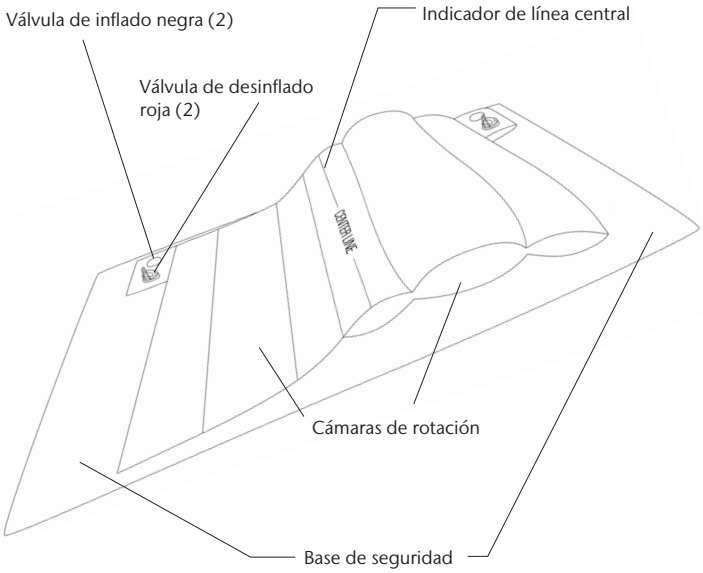

Identificación de piezas: Bomba insufladora de aire

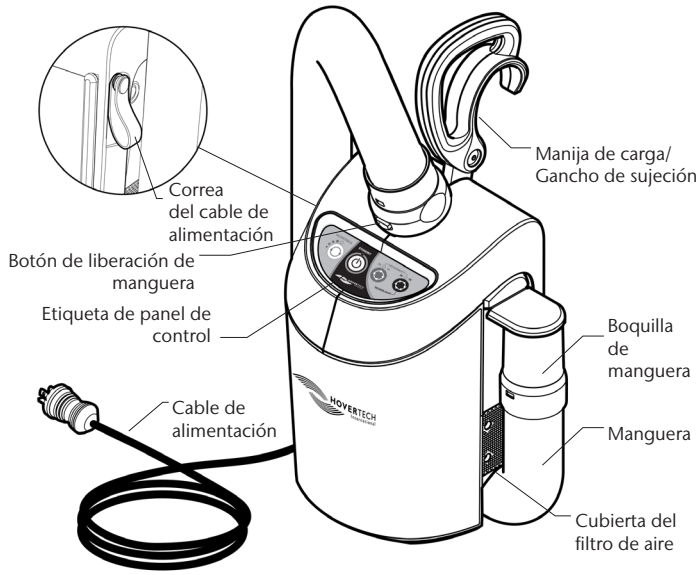

ADVERTENCIA: El dispositivo HT-Air no es compatible con la corriente eléctrica continua. El dispositivo no debe usarse con el equipo HoverJack Battery Cart.

PRECAUCIÓN: NINGUNA DE LAS PIEZAS PUEDE SER MANTENIDA POR EL USUARIO. Solo el personal de mantenimiento calificado debe realizar reparaciones en el dispositivo HoverTech International Bomba insufladora de aire.

Funciones del teclado de la Bomba insufladora de aire

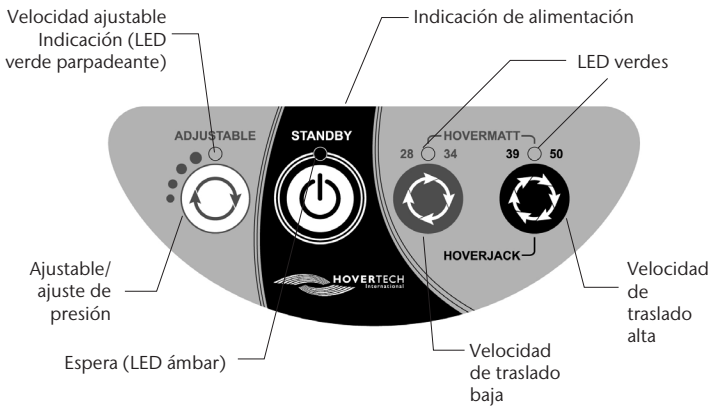

La función AJUSTABLE tiene cuatro ajustes diferentes. Cada vez que toque el botón, aumentarán la presión de aire y la velocidad de inflado. La luz LED verde parpadeante indica la velocidad de inflado según la cantidad de parpadeos (es decir, dos parpadeos son igual a la segunda velocidad de inflado).

ESPERA: Se usa para detener el inflado/el flujo de aire (la luz LED ámbar indica el modo de ESPERA).

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que las válvulas de desinflado rojas estén bien cerradas antes de comenzar a inflar.
2. Coloque el dispositivo Q2Roller sobre el colchón de la cama y céntrelo usando el indicador de línea central.
3. Coloque la base se seguridad del Q2Roller debajo del colchón para que no se mueva durante el uso.
4. Retire la parte trasera de las tiras adhesivas de la Q2R Pad y céntrela sobre el Q2Roller (si el paciente ya está sobre el colchón, coloque el dispositivo y la almohadilla debajo del paciente usando la técnica de rotación en bloque).
5. Con el paciente centrado sobre el dispositivo, asegúrese de que todas las barandillas de la cama o la camilla estén levantadas o siga el protocolo de su centro.
6. Ubique la válvula de inflado en el lado OPUESTO de la dirección de rotación y coloque la manguera de suministro de aire en esa válvula. Presione el botón AJUSTABLE del dispositivo HT-Air para comenzar el flujo. De ser necesario, presione este botón hasta 3 veces más para aumentar el flujo de aire y la tasa de inflado.
7. Cuando se complete el giro, retire la manguera de la válvula y presione el botón ESPERA del dispositivo de suministro de aire. Es posible que la cámara no deba inflarse completamente para lograr la posición deseada.
8. Para desinflar rápidamente el dispositivo Q2Roller, quite la tapa roja de la válvula de desinflado. Para desinflar lentamente o ajustar la cámara, presione el centro de la válvula de inflado negra.

Especificaciones del producto y accesorios necesarios

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Material:	Poliuretano
Construcción:	Soldadura por radiofrecuencia
Ancho:	Cámaras: 46.5 in (118 cm) (ancho combinado de las cámaras) Base: 72 in (183 cm)
Largo:	Cámaras: 44.5 in (113 cm) Base: 44 in (112 cm)

SIN LÁTEX

N.° de modelo: HTR-200
Límite de peso: 600 lb (272 kg)
Uso con un solo paciente

Q2R® PAD

Material:	Polietileno respirable no tejido
Construcción:	Ligamento térmico
Ancho:	39 in (99 cm)
Largo:	39 in (99 cm)

N.° de modelo: HTR-CHX-5PACK (5 cada uno)
N.° de modelo: HTR-CHX-CASE (50 cada uno)

ACCESORIOS NECESARIOS:

N.° de modelo: HTAIR1200 (versión norteamericana) – 120V~, 60 Hz, 10A
N.° de modelo: HTAIR2300 (versión europea) – 230V~, 50 Hz, 6A
N.° de modelo: HTAIR1000 (versión japonesa) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
N.° de modelo: HTAIR2356 (versión coreana) – 230V~, 50/60 Hz, 6A

Limpieza y mantenimiento

LIMPIEZA

El dispositivo Q2Roller es un dispositivo para uso con un solo paciente. Si el dispositivo se ensucia, límpielo completamente usando un limpiador germicida (desinfectante fenólico, solución cuaternaria u otro desinfectante de nivel intermedio según los procedimientos del centro) para desinfectar. Para obtener mejores resultados, siga el tiempo de espera y las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante del limpiador. Aplique el limpiador germicida directamente sobre las zonas difíciles de alcanzar. Deje que se seque al aire. No lavar.

CONTROL DE INFECCIONES

Se recomienda usar la almohadilla Q2R Pad sobre el Q2Roller para evitar que el dispositivo se ensucie (también se vende por separado). También se pueden usar otros materiales, como sábanas, sobre el dispositivo Q2Roller para mantenerlo limpio.

Si el dispositivo Q2Roller se usa con un paciente aislado, el hospital deberá emplear los mismos protocolos y procedimientos que usará para los colchones o la ropa de cama de ese paciente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA INSUFLADORA DE AIRE

Consulte el manual del dispositivo para referencia.
NOTA: CONSULTE LAS PAUTAS LOCALES, ESTATALES, FEDERALES O INTERNACIONALES ANTES DE DESECHAR EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Antes del uso, debe realizarse una inspección visual del dispositivo Q2Roller para garantizar que no haya daños visibles que lo dejen inutilizable.

El dispositivo Q2Roller debe inspeccionarse periódicamente para garantizar lo siguiente:

- Que todas las válvulas de inflado se cierren solas, sin signos de pérdidas
- Que no haya perforaciones ni rasgones en el dispositivo Q2Roller

Si se detectan daños que provocarían que el dispositivo no funcione como debería, el dispositivo Q2Roller debe desecharse.

Devoluciones y reparaciones

Todos los productos devueltos a HoverTech International (HTI) deben tener un número de autorización de bienes devueltos (RGA) emitido por la empresa. Llame al 800-471-2776 y pregunte por un miembro del equipo de RGA para que le asignen este número. Cualquier producto devuelto sin un número de RGA provocará un retraso en el tiempo de reparación.

Los productos devueltos deben enviarse a:
HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
Attn: RGA #_____
Teléfono: 800-471-2776
Fax: 610-694-9601

HOVERTECH International

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

1.800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com